

广州质量监督检测研究院
报告附件

抽送样单号: ML20221124


第 1 页 共 4 页

辐射骚扰

检测结果

产品名称: 颈椎按摩器
型号: F8
测试标准: GB 4343.1-2018
测试电压/频率: 5V $\square$
环境温度/湿度: 21°C/55%RH
测试极性: 水平、垂直
工作模式: 充电、自动模式、强度 16、热敷功能开
测试日期: 2022-11-24
不确定度: 30MHz-200MHz 水平: 3.82dB 垂直: 3.96dB
200MHz-1000MHz 水平: 4.99dB 垂直: 6.01dB
备注: “Margin” 值为负值(-)表示超出标准限值, “Pol” 为(H)表示天线水平极化, “Pol” 为(V)表示天线垂直极化。

Test Graph

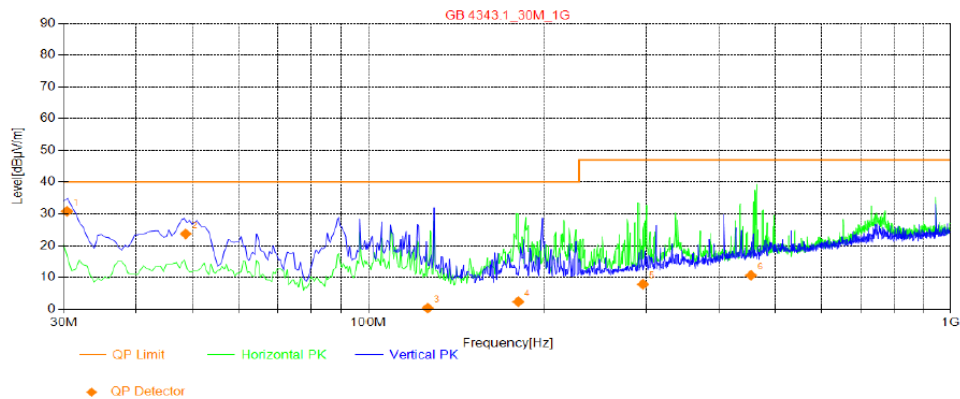

Final Data List

NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	IF Band [KHz]	QP Value [dBμV/m]	QP Limit [dBμV/m]	QP Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	30.4158	-23.19	120	30.77	40.00	9.23	100	356	Vertical
2	48.6565	-19.94	120	23.68	40.00	16.32	133	3	Vertical
3	126.3362	-24.66	120	0.31	40.00	39.69	133	360	Vertical
4	180.7345	-23.89	120	2.32	40.00	37.68	117	42	Horizontal
5	296.0940	-19.10	120	7.81	47.00	39.19	117	267	Horizontal
6	454.0830	-15.03	120	10.64	47.00	36.36	100	198	Horizontal

批准: 张峰

审核: 赖俊斌


主检: 张钢

广州质量监督检测研究院
报告附件

抽送样单号：ML20221124

第 2 页 共 4 页

辐射骚扰检测布置图

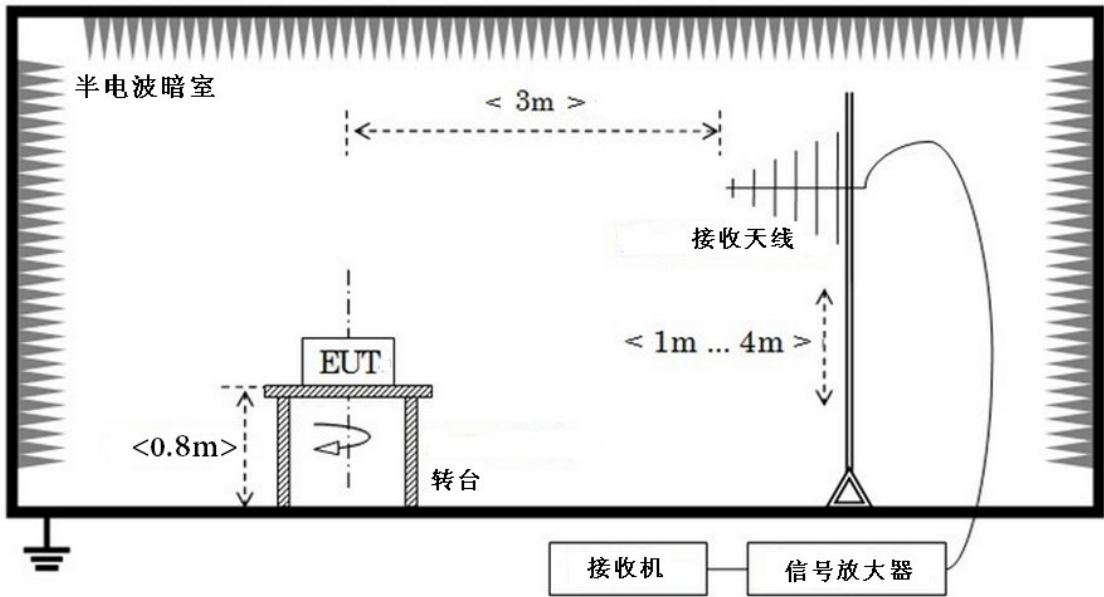

布置说明:

1. 受检设备布置在 0.8 米高的绝缘测试桌上；
2. 受检设备各单元之间的距离为 0.1 米，各单元放置位置、互联缆线及外连缆线应按正常使用情况来布置；
3. 受检设备与测试桌后沿切齐，单元间的电缆应从试验桌的后边缘垂落，沿其中间位置折叠成不大于 0.4 米的线束，以保证其距离水平接地参考平面至少 0.4 米。

仪器清单

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号	校准有效期至
1	3m 法电波暗室	----	D40346	2027-05-16
2	EMI 接收机	ESR3	D40350	2023-09-21
3	宽带接收天线	VULB9163	D40340	2024-01-09

辅助设备

序号	仪器名称	品牌	型号	序号
1	电源适配器	MEIZU	UP0515S	AH1841001MND1

批准：张峰

审核：赖俊斌

主检：张钢

广州质量监督检测研究院

报告附件

抽送样单号：ML20221124

第 3 页 共 4 页

检测照片



样品照片



批准：张峰

审核：赖俊斌

主检：张钢


广州质量监督检测研究院

报告附件

抽送样单号：ML20221124

第 4 页 共 4 页

标签信息

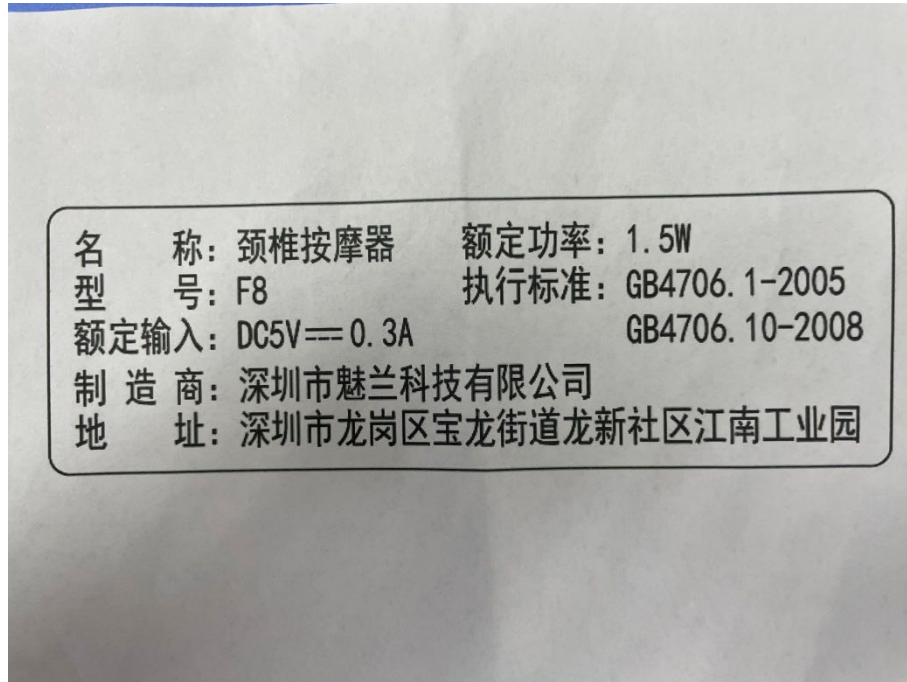

批准：张峰

审核：赖俊斌

主检：张钢